



ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



**БМГ ПЛЮС**

СТАБИЛЬНЫЙ ПУЛЬС ВАШИХ СИСТЕМ

**ГК154-П**

**Генераторы кварцевые:**

- (соответствуют гр. 4У КГВС “Климат-7”, “Мороз-6”)
- **СПЕЦВОЗДЕЙСТВИЯ: гр. 2Ус**
- **повышенная температурная стабильность**
- **повышенная точность настройки частоты**
- **напряжение питания: +5В или +3,3 В**
- **точность симметрии импульсов: лучше 5%**
- **большой ресурс наработки**
- **низкие фазовые шумы**

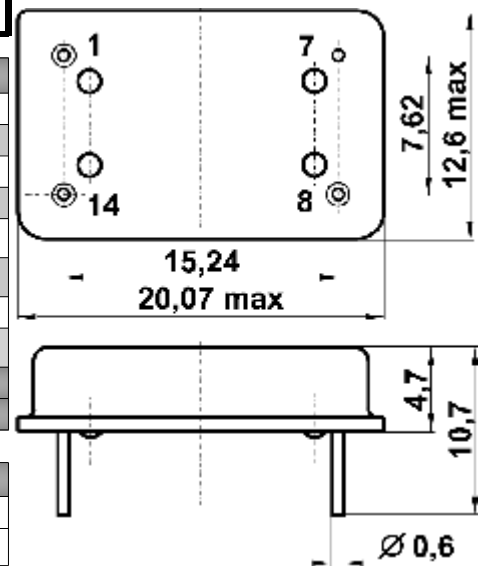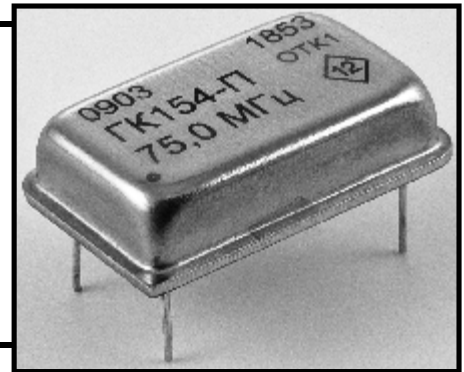

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Наработка (ресурс генератора):	50000 ч. (80000ч. для генераторов со звездочкой)
Одиночный удар:	1500 г, 0,1-2 мс
Многokратные удары:	150 г, 1-5 мс
Синусоидальная вибрация:	1 - 2000 Гц, 20 г
Влажность:	98% при T=35 <sup>0</sup> C
Пониженное атмосферное давление:	5 мм. рт. ст.
Срок сохраняемости:	15 лет
Температура хранения:	(-60... +85) <sup>0</sup> C
Генераторы соответствуют техническим условиям ТУ 6329-001-07604008-02 ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ МОП 44001.10	

**ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ КОРПУСА DIL14 (для GK154-П)**

1. Не подсоединен.	7. Корпус.
8. Выход частоты.	14. Питание.

**КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ВП**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Диапазон частот	МГц	2,0 - 100,0		
Точность настройки частоты *	х10 <sup>-6</sup>	от ± 2,5		
Интервал рабочих температур *	<sup>0</sup> C	- 60... +85	- 40... +70	- 10... +60
Температурная нестабильность частоты *	х10 <sup>-6</sup>	от ±40	от ±25	от ±10
Напряжение питания	В	3,3 ± 5% или 5 ± 5%		
Потребляемый ток (частотнозависимый)	мА	≤50		
Выходной сигнал	---	КМОП		
Длительность фронта/спада импульса	нс	5		
Симметрия импульсов	%	45 - 55		
Нагрузка	---	10 - 15 пФ		
Старение за первый год	х10 <sup>-6</sup>	± (2 - 3)		

\* Возможные варианты нестабильности в интервалах температур для данного типа генератора

Температурная нестабильность, $\times 10^{-6}$	$\pm 10$ (И)	$\pm 25$ (М)	$\pm 30$ (Н)	$\pm 40$ (П)	$\pm 50$ (Р)
Интервалы рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$					
-10... +60 ( А )	X	X			
-30... +60 ( Е )	X		X		
-40... +70 ( Б )		X		X	
-60... +85 ( Г )				X	X

- Звоните для уточнения параметров; X - Возможные варианты; ? - Варианты прорабатываются

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА\*

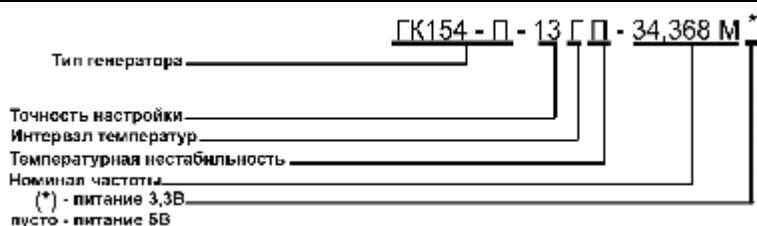


при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит:  
 - из слова "Генератор";  
 - полного обозначения генератора по ОСТ 11 ОДО.338.009-78 и таблице 2;  
 - номинала частоты и обозначения ТУ.

**ТАБЛИЦА 2** для заказа параметров изделий с приемкой "5"

Электрические параметры	Норма (обозначения при заказе и в КД)	
	ГК154-П	ГК154-С
Диапазон частот, МГц	2,0 - 100,0	8,0 - 300,0
Точность настройки частоты при $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , $\times 10^{-6}$	Для частот 2 - 30 МГц	Для частот 8 - 30 МГц
	$\pm 2,5$ (10)- только для групп АИ, ЕИ;	$\pm 5$ (11); $\pm 10$ (13);
	Для частот 30 - 100 МГц	Для частот 30 - 300 МГц
	$\pm 10$ (13); $\pm 20$ (15); $\pm 30$ (16);	
Температурная нестабильность в интервале рабочих температур, $\times 10^{-6}$		
- 10... +60 ( А )	$\pm 10$ (И);	$\pm 25$ (М);
- 40... +70 ( Б )	$\pm 25$ (М);	$\pm 40$ (П);
- 60... +85 ( Г )	$\pm 40$ (П);	$\pm 50$ (Р);
- 30... +60 ( Е )	$\pm 10$ (И);	$\pm 30$ (Н);

Пояснения к маркировке изделий:

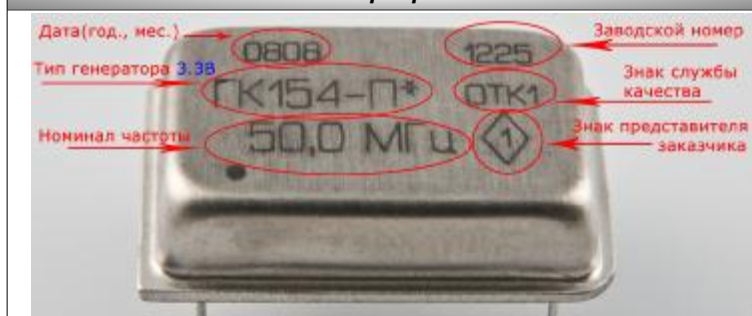

■ Каждое изделие снабжается паспортом с указанием заводского номера, даты изготовления, номера ТУ и результатов испытаний, заверенных штампом ОТК и штампом ПЗ.

■ Все изделия отгружаются в специально разработанных упаковках, где предусмотрена защита выводов корпуса генератора от деформации. Каждая упаковка обклеивается бумажной лентой с логотипом фирмы, количеством и наименованием типа изделий, заверенной штампом ОТК и штампом ПЗ.

Редакция: от 09/2009